


# ULINE H-7352 DIGITAL CALIPER

1-800-295-5510  
uline.com



## SAFETY

### ⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: LR44.
- Nominal battery voltage: 1.5V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 104°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

# OPERATION

 **NOTE:** Remove battery insulation tag before first use.

## CALIPER BEAM GRADUATIONS

Lower edge of caliper beam is scaled in tenths of an inch (0.1) and measures up to 6". Each full inch and incremental tenth of an inch is indicated.


Upper edge of caliper beam is scaled in millimeters and measures up to 150 mm. Every millimeter is indicated.

## LCD DISPLAY

- Large (7/16") digits
- Resolution: 1/64", 0.0005" and 0.01 mm

## MEASURING MODES

Switch between three units using the **MODE** button. (See Figure 1)



## SETUP

 **NOTE:** Use only LR44 coin cell batteries.


1. Using a small Phillips screwdriver, loosen the battery compartment screw (J) on the back of the caliper.

 **NOTE:** Screw is not removable.

2. Slide battery cover (I) off the device.
3. Remove old battery. Insert new battery with the positive side up.
4. Slide battery cover back on the device and tighten screw to secure.


 **CAUTION!** Discontinue use of the device if screw is lost or no longer secures the battery compartment.

A	Caliper Beam Graduations
B	LCD Display
C	Beam Clamp Screw
D	Beam Reading Reference Indicator
E	Measuring Jaw Thumb Rest and Roller
F	On/Off Button
G	Mode Button
H	Zero Adjust Button
I	Battery Cover
J	Battery Cover Screw



**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com



## SEGURIDAD

### ¡ADVERTENCIA!

- **RIESGO POR INGESTIÓN:** Este producto contiene una batería de botón.
- Puede ocasionar la **MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Ingerir una batería de botón puede producir **Quemaduras Químicas Internas** en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- Si se sospecha la ingestión o inserción de una batería en cualquier parte del cuerpo consulte a su médico de inmediato.



- Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías usadas conforme a las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. **NO** deseche las baterías en la basura o las incinere.
- Incluso las baterías usadas podrían causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro de información toxicológica local para información de tratamiento.
- Tipo de batería compatible: LR44.
- Voltaje nominal de batería: 1.5V.
- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- No fuerce la descarga, no recargue, no desensamble ni caliente por encima de los 40°C (104°F) o incinere. Hacerlo podría provocar lesiones debido a la liberación de gases, fugas o explosiones que resulten en quemaduras por químicos.
- Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías viejas con nuevas, de diferentes marcas o tipos, como alcalinas, carbono-zinc o recargables.
- Retire y recicle o deseche de inmediato las baterías del equipo no usadas durante un periodo extendido de acuerdo con regulaciones locales.
- Cierre siempre bien el compartimento de la batería. Si el compartimento no cierra bien, deje de usar el producto, retire la batería y manténgala fuera del alcance de los niños.

# FUNCIONAMIENTO

 **NOTA:** Retire la etiqueta colgante de aislamiento de la batería antes del primer uso.

## GRADUACIONES DE LA REGLA DEL CALIBRADOR

El extremo inferior de la regla del calibrador está graduado en décimas de pulgada (0.1) y mide hasta 6". Se indican cada pulgada completa y décima parte incremental de un pulgada.


El extremo superior de la regla del calibrador está graduado en milímetros y mide hasta 150 mm. Se indica cada milímetro.

## PANTALLA LCD

- Dígitos Grandes (7/16")
- Resolución: 1/64", 0.0005" y 0.01 mm

## MODOS DE MEDICIÓN

Cambie entre tres unidades diferentes con el botón **MODE** (MODO). (Vea Diagrama 1)




## CONFIGURACIÓN

 **NOTA:** Use solo baterías tipo botón LR44.

1. Con un pequeño desarmador de cruz, afloje el tornillo del compartimento de la batería (J) en la parte posterior del calibre.


 **NOTA:** El tornillo no es removible.

2. Deslice la cubierta de las baterías (I) del dispositivo.
3. Retire la batería antigua. Inserte la batería nueva con el lado positivo hacia arriba.
4. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías en el dispositivo y apriete el tornillo para asegurarlo.


 **¡PRECAUCIÓN!** Descontinúe el uso del dispositivo si se pierde el tornillo o ya no fija el compartimento de baterías.

A	Graduaciones de la Regla del Calibrador
B	Pantalla LCD
C	Tornillo de la Abrazadera de la Regla
D	Indicador de Referencia de Lectura de la Regla
E	Apoyo para el Pulgar y Rodillo de la Mordaza de Medición
F	Botón de Encendido/Apagado
G	Botón de Modo
H	Botón de Ajuste a Cero
I	Cubierta de las Baterías
J	Tornillo del Compartimento de Baterías

### VISTA FRONTAL



### VISTA POSTERIOR




**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE H-7352**  
**PIED À COULISSE**  
**NUMÉRIQUE**

1 800 295-5510  
uline.ca



## SÉCURITÉ

### ⚠ AVERTISSEMENT

- **DANGER D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou pile plate.
- L'ingestion de cette pile peut entraîner **LA MORT** ou des blessures graves.
- Le fait d'avaler une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en 2 heures à peine.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- Obtenez immédiatement des soins médicaux si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



- Retirez les piles usagées et recyclez-les ou mettez-les au rebut immédiatement conformément à la réglementation locale et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles dans les ordures ménagères ni au feu.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement des blessures.
- Type de pile compatible : LR44.
- Tension nominale de la pile : 1,5 V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge des piles. Ne tentez pas de les recharger, de les démonter, de les chauffer à plus de 40 °C (104 °F) ou de les jeter au feu. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une émission de gaz, à une fuite ou à une explosion susceptible de causer des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ou des piles de marques ou de types différents, telles que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
- Retirez les piles des appareils qui ne sont pas utilisés pendant une longue période et recyclez-les ou mettez-les au rebut immédiatement, conformément à la réglementation locale.
- Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil, retirez les piles et gardez le tout hors de portée des enfants.

# FONCTIONNEMENT

 **REMARQUE :** Retirez l'étiquette isolante de la pile avant la première utilisation.

## GRADUATIONS DE LA RÈGLE DU PIED À COULISSE

Le bord inférieur de la règle du pied à coulisse est gradué en dixièmes de pouce (0,1) et mesure jusqu'à 6 po. Chaque pouce complet et chaque intervalle d'un dixième de pouce sont indiqués.


Le bord supérieur de la règle du pied à coulisse est gradué en millimètres et mesure jusqu'à 150 mm. Chaque millimètre est indiqué.

## ÉCRAN ACL

- Grands chiffres (7/16 po)
- Résolution : 1/64 po, 0,0005 po et 0,01 mm

## MODES DE MESURE

Passez d'une unité à l'autre (trois unités distinctes) à l'aide de la touche **MODE**. (Voir Figure 1)




## INSTALLATION

 **REMARQUE :** Utilisez uniquement des piles boutons LR44.


1. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis du compartiment à piles (J) situé à l'arrière du pied à coulisse.

 **REMARQUE :** La vis n'est pas amovible.

2. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles (I) pour le retirer.
3. Retirez l'ancienne pile. Insérez la nouvelle pile avec le pôle positif vers le haut.
4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et serrez la vis pour le fixer.

 **MISE EN GARDE!** Cessez d'utiliser l'appareil si la vis a été perdue ou si elle ne permet plus de fixer le compartiment à piles.

A	Graduations de la règle du pied à coulisse
B	Écran ACL
C	Vis de serrage pour règle
D	Indicateur de référence de lecture de la règle
E	Appui-pouce et rouleau de la mâchoire de mesure
F	Touche marche/arrêt
G	Touche " Mode " (mode)
H	Touche de réglage du zéro
I	Couvercle du compartiment à piles
J	Vis du couvercle du compartiment à piles

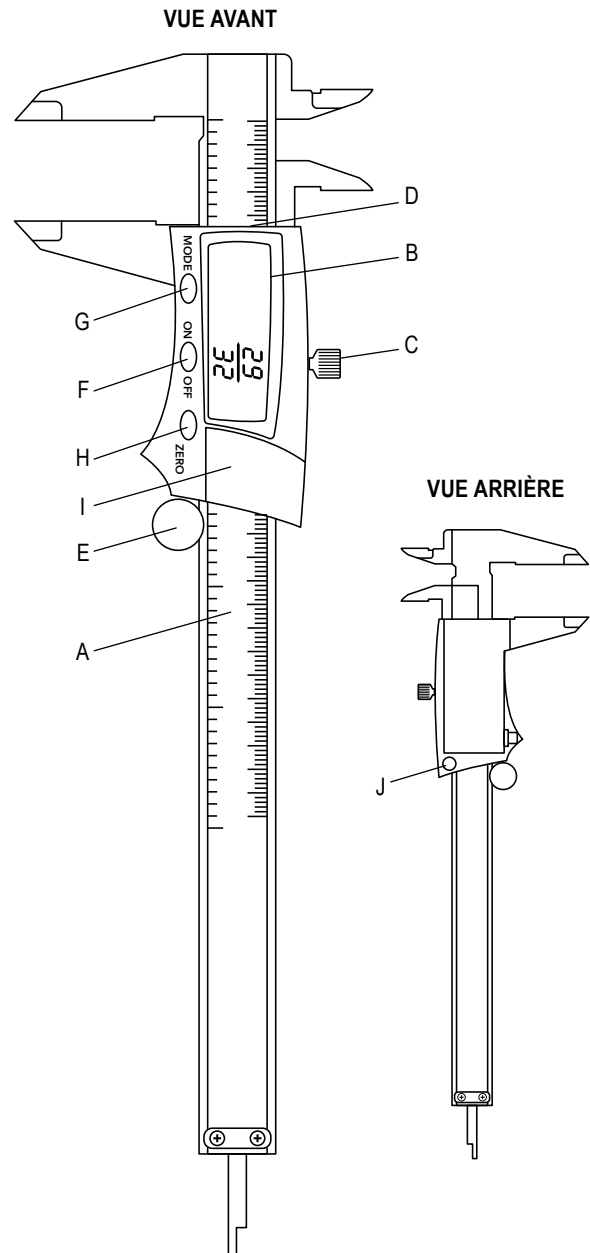

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca