


ULINE H-9459

EYEWASH DRENCH HOSE – DECK MOUNT

1-800-295-5510
uline.com

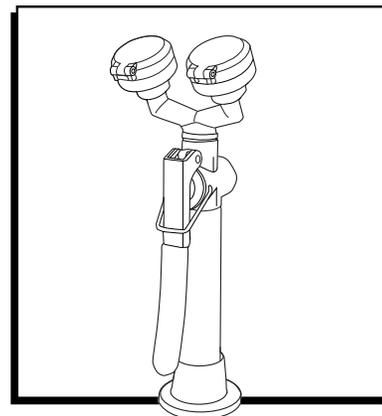

TOOLS NEEDED




Electric Drill



1/4" Drill Bit

PARTS



8' Hose x 1




Handle x 1




Deck Flange x 1



45° Panel Flange x 1



Spray Head x 2



Squeeze Valve x 1

SAFETY



CAUTION! In the event of a chemical splash or spill, affected area of the victim's body must be flushed immediately for at least 15 minutes. For chemical spills to the eyes, user should hold eyes open as wide as possible to permit water to reach all areas around the eye.



CAUTION! Rinsing affected area for 15 minutes is only the first step in treating exposure to a hazardous chemical. Following rinsing, victim should be examined and treated by a doctor or other trained medical specialist as soon as possible.

INSTALLATION




NOTE: Unit should be installed by licensed plumber.



NOTE: Thoroughly clean and flush supply line prior to installing unit. Pipe shavings, scale, tape and other debris can be carried through a pipe and into unit when system is activated. This debris can damage valve components and interfere with proper operation of the valve.

- The water supply line should have outside diameter of at least 1/2" and should be copper or other corrosion-resistant material.
- Unit requires a 1 3/8" diameter mounting hole. Hole should be large enough to accommodate the shank on the deck flange but not allow excessive lateral movement. Minimizing the hole size provides as large a surface as possible to secure the locknut.

- Unit has a 3/8" NPT male thread on inlet. (See Figure 1) Use Teflon® tape or other pipe sealant to seal thread. Do not apply sealant in a way that will allow it to enter into unit.

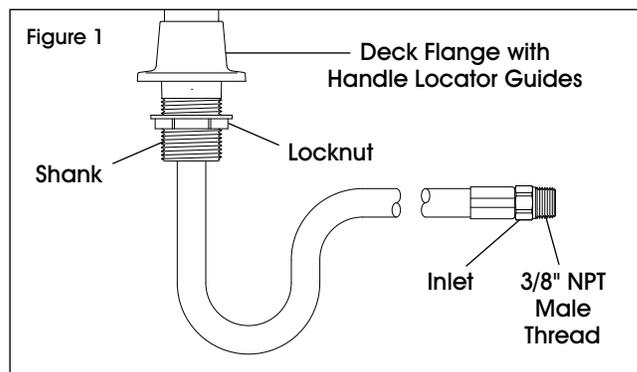

INSTALLATION CONTINUED



NOTE: Install unit with adequate clear space around. In an emergency, unit should be readily accessible to the user without interference from other equipment, such as mixing faucets, pegboards, instrumentation, etc.



NOTE: Unit should be installed 6" from wall.



NOTE: Install unit so handle and spray heads face forward toward user. This requires installing the deck flange with handle locator guides properly positioned. (See Figure 1)



NOTE: No sharp edges, corners or objects should rub against hose. Ensure unit is accessible from front edge of counter on which it is installed.



NOTE: Unit must pull out easily from deck flange without restriction. Keep hose free from obstructions to prevent hose from kinking.

MAINTENANCE



NOTE: Unit must be inspected on a regular basis.

Weekly Activation: This is required by the provisions of ANSI Z358.1-2014.

Monthly Maintenance Inspection: This should incorporate the recommended weekly activation of the unit, as well as a thorough inspection of the unit to ensure that it is in good operating condition and showing no signs of wear. Pay attention to the spray heads, valve and hose assembly.

Annual Compliance Inspection: All emergency equipment should be inspected at least annually to verify continued compliance with the provisions of ANSI Z358.1-2014.

Clean unit using only a soft cloth and soapy water. Do not use abrasives, detergents or other cleaners that can damage the finish on the unit.



WARNING! Never use cleaning agent that contains ammonia near a laboratory service fitting or emergency eyewash unit, as ammonia will aggressively corrode brass contained in these products.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9459

LAVAJOS CON MANGUERA DE ENJUAGE – INSTALACIÓN EN CUBIERTA

800-295-5510

uline.mx

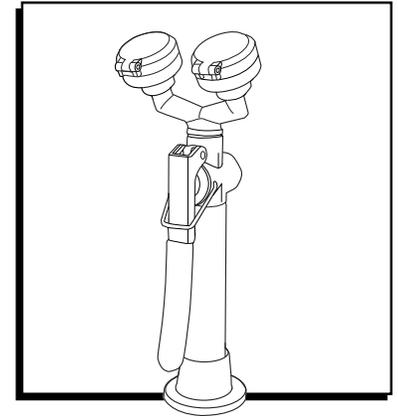

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro Eléctrico



Broca de 1/4"

PARTES



1 Manguera de 8'




1 Mango




1 Conexión para Cubierta



1 Conexión de 45° para Panel



2 Cabezales Difusores



1 Válvula de Presión

SEGURIDAD



¡PRECAUCIÓN! En caso de salpicaduras o derrames de productos químicos, el área afectada del cuerpo debe enjuagarse inmediatamente durante al menos 15 minutos. En el caso de derrames de productos químicos en los ojos, el usuario debe mantener los ojos abiertos lo más posible para permitir que el agua llegue a todas las áreas alrededor del ojo.



¡PRECAUCIÓN! Enjuagar el área afectada durante 15 minutos es solo el primer paso para tratar la exposición a una sustancia química peligrosa. Después del enjuague, el afectado debe consultar a un médico y recibir tratamiento lo antes posible.

INSTALACIÓN




NOTA: La unidad debe instalarla un plomero certificado.



NOTA: Limpie y enjuague a fondo la línea de suministro antes de instalar la unidad. Cuando el sistema está activado pueden pasar a través de la tubería astillas, sarro, cinta y otros residuos y entrar a la unidad. Estos residuos pueden dañar los componentes de la válvula e interferir con su correcto funcionamiento.

- La línea de suministro de agua debe tener un diámetro exterior de 1/2" como mínimo y debe ser de cobre u otro material resistente a la corrosión.
- La unidad requiere un orificio de montaje de 1 3/8" de diámetro. El orificio debe ser lo suficientemente grande para acomodar el vástago en la conexión para cubierta, pero no debe permitir un movimiento lateral excesivo. Minimizar el tamaño del orificio proporciona una superficie lo más grande posible para asegurar la contratuerca.

- La unidad tiene una rosca estándar macho de 3/8" en la entrada. (Vea Diagrama 1) Use cinta Teflon® u otro sellador de tuberías para sellar la rosca. Aplique el sellador evitando que entre en la unidad.

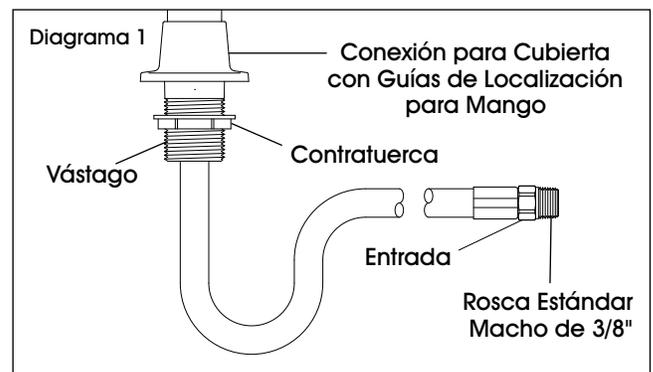

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN



NOTA: Instale la unidad con suficiente espacio libre alrededor. En una emergencia, la unidad debe tener fácil acceso para el usuario sin interferencia de otros equipos, como llaves mezcladoras, paneles ranurados, instrumentación, etc.



NOTA: La unidad debe instalarse a 6" de la pared.



NOTA: Instale la unidad de modo que el mango y los cabezales difusores miren hacia el usuario. Esto requiere instalar la conexión para cubierta con las guías de localización del mango colocadas correctamente. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Bordes, esquinas u objetos afilados no deben rozar la manguera. Asegúrese de que se puede acceder a la unidad desde el borde frontal del mostrador en el que la instala.



NOTA: La unidad debe extraerse fácilmente de la conexión para cubierta sin restricción de acceso. Mantenga la manguera libre de obstrucciones para evitar que se fuerza.

MANTENIMIENTO



NOTA: La unidad debe inspeccionarse periódicamente.

Activación Semanal: Esto es requerido por las disposiciones de ANSI Z358.1-2014.

Inspección de Mantenimiento Mensual: Esto debe incorporar la activación semanal recomendada de la unidad, así como una inspección minuciosa para asegurarse de que esté en buenas condiciones de funcionamiento y no muestre signos de desgaste. Preste atención a los cabezales difusores, la válvula y partes de la manguera.

Inspección de Cumplimiento Anual: Todo equipo de emergencia debe inspeccionarse al menos una vez al año para verificar su cumplimiento continuo de las disposiciones de ANSI Z358.1-2014.

Limpie la unidad con un paño suave y agua jabonosa. No utilice abrasivos, detergentes u otros limpiadores que puedan dañar el acabado de la unidad.



¡ADVERTENCIA! Nunca use un producto de limpieza que contenga amoníaco cerca de un accesorio de servicio de laboratorio o unidad de lavado de ojos de emergencia, ya que el amoníaco corroerá agresivamente el latón contenido en estos productos.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-9459

DOUCHE OCULAIRE À TUYAU – FIXATION SUR COMPTOIR

1-800-295-5510

uline.ca

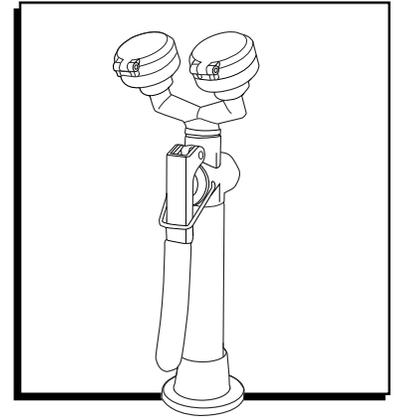

OUTILS REQUIS




Perceuse
électrique



Mèche de perceuse
de 1/4 po


PIÈCES



Tuyau de 8 pi x 1




Poignée x 1



Bride de plateforme x 1



Bride de panneau de 45° x 1



Tête de pulvérisation x 2



Vanne de
pulvérisation x 1

SÉCURITÉ



MISE EN GARDE! En cas d'éclaboussure ou de déversement de produits chimiques, la partie du corps de la victime doit être immédiatement rincée pendant au moins 15 minutes. En cas de déversement de produits chimiques dans les yeux, l'utilisateur doit tenir les yeux ouverts aussi largement que possible pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les zones autour de l'œil.



MISE EN GARDE! Le rinçage de la zone affectée pendant 15 minutes est uniquement la première étape du traitement de l'exposition à un produit chimique dangereux. Après le rinçage, la victime doit être examinée et traitée par un médecin ou un autre spécialiste médical qualifié dès que possible.

INSTALLATION




REMARQUE : L'appareil doit être installé par un plombier agréé.



REMARQUE : Nettoyez et rincez soigneusement la conduite d'alimentation avant d'installer l'appareil. Des copeaux de tuyaux, du tartre, du ruban adhésif et d'autres débris peuvent être transportés dans un tuyau et dans l'appareil lorsque le système est activé. Ces débris peuvent endommager les composants de la vanne et nuire à son bon fonctionnement.

- La conduite d'alimentation en eau doit avoir un diamètre extérieur d'au moins 1/2 po et doit être en cuivre ou autre matériau résistant à la corrosion.
- L'appareil nécessite un trou de fixation de 1 3/8 po de diamètre. Le trou doit être assez large pour accommoder la tige de la bride de plateforme, sans permettre trop de mouvement latéral. La réduction de la taille du trou permet d'obtenir une surface aussi grande que possible pour fixer l'écrou de blocage.

- L'appareil est doté d'un filetage NPT mâle de 3/8 po à l'entrée. (Voir Figure 1) Utilisez du ruban Teflon^{MD} ou un autre produit d'étanchéité pour tuyaux pour sceller le filetage. Appliquez le produit d'étanchéité de manière à ce qu'il ne puisse pas s'introduire dans l'appareil.

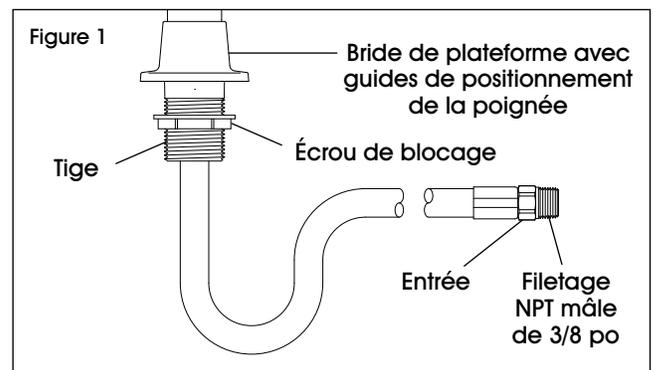

INSTALLATION SUITE



REMARQUE : Installez l'appareil en laissant suffisamment d'espace libre autour. En cas d'urgence, l'appareil doit être facilement accessible à l'utilisateur sans interférence avec d'autres équipements, tels que les robinets mélangeurs, les tableaux d'affichage, les instruments, etc.



REMARQUE : L'appareil doit être installé à 6 po du mur.



REMARQUE : Installez l'appareil de façon à ce que la poignée et les têtes de pulvérisation soient orientées vers l'avant, vers l'utilisateur. Pour ce faire, la bride de plateforme doit être installée avec les guides de positionnement de la poignée correctement mis en place. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Aucun bord, coin ou objet pointu ne doit toucher le tuyau. Assurez-vous que l'appareil est accessible depuis le bord de comptoir sur lequel il est installé.



REMARQUE : L'appareil doit pouvoir être retiré facilement de la bride de plateforme sans obstacle. Gardez le tuyau libre de toute obstruction pour éviter qu'il ne se plie.

ENTRETIEN



REMARQUE : L'appareil doit être inspecté régulièrement.

Activation hebdomadaire : Ceci est requis par les dispositions de la norme ANSI Z358.1-2014.

Inspection mensuelle de maintenance : Cette opération doit comprendre l'activation hebdomadaire recommandée de l'appareil, ainsi qu'une inspection approfondie de l'appareil pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et ne présente aucun signe d'usure. Portez une attention particulière aux têtes de pulvérisation ainsi qu'à l'ensemble de la vanne et du tuyau.

Inspection annuelle de conformité : Tous les équipements d'urgence doivent être inspectés au moins une fois par an pour vérifier leur conformité aux dispositions de la norme ANSI Z358.1-2014.

Nettoyez l'appareil en utilisant uniquement un chiffon doux et de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits abrasifs, de détergents ou d'autres nettoyants qui pourraient endommager le fini de l'appareil.



AVERTISSEMENT! N'utilisez jamais de produit de nettoyage contenant de l'ammoniac à proximité d'un raccord de service de laboratoire ou d'une douche oculaire d'urgence, car l'ammoniac corrode de manière agressive le laiton contenu dans ces produits.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca